

USB Desktop Biometric Reader

*Lecteur biométrique de bureau USB
Lettore biometrico da scrivania (USB)
Lector biométrico de mesa con USB
USB Fingerabdruck Schreibtischleser
USB biometrische desktooplezer*

INSTALLERS'S MANUAL



BIOE enables easy fingerprint enrollment from operator's desk. The use of BIOE is not mandatory, since the enrollment can be done from any biometric reader installed in the network.

Le BIOE permet de réaliser l'enregistrement des empreintes facilement depuis un bureau. L'utilisation du BIOE n'est pas obligatoire, car l'enregistrement peut aussi se réaliser depuis n'importe quel lecteur biométrique installé dans un réseau.

BIOE consente una facile acquisizione delle impronte dalla scrivania dell'operatore. L'uso di BIOE non è obbligatorio in quanto l'acquisizione può essere effettuata da qualsiasi lettore biometrico installato in rete.


BIOE permite realizar el registro de huellas fácilmente desde la mesa. El uso del BIOE no es obligatorio, ya que el registro se puede hacer desde cualquier lector biométrico instalado en red.

Der BIOE ermöglicht das einfache Einlesen des Fingerabdrucks von Ihrem Schreibtisch aus. Die Nutzung des BIOE ist nicht zwingend, da das Einlesen auch von jedem anderen, im Netzwerk installierten Leser, getan werden kann.

BIOE registreert vingerafdrukken eenvoudig vanaf de desk van de operator. Het gebruik van BIOE is niet verplicht, aangezien de registratie kan plaatsvinden via elke willekeurige biometrische lezer binnen het netwerk.


► SPECIFICATIONS

| | |
|-------------------------|--|
| Interface: | USB |
| Software compatibility: | PROS CS and BIOMANAGER CS |
| Reader Compatibility: | BIOC3, BIOPROX-EH, BIOPROX-MF, BIOPAD-M |
| O/S compatibility: | Windows 7, 8, 10 Windows Server 2008, 2012 |
| Fingerprint sensor: | Optical (Scratch free sensor surface) |
| Resolution: | 500 dpi / 256 gray |
| Operating Temperatures: | -10°C to +50°C |
| Dimensions (LxHxW): | 66 x 58 x 90 mm |



► SPÉCIFICATIONS

| | |
|---|--|
| Interface: | USB |
| Logiciel compatible: | PROS CS et BIOMANAGER CS |
| Lecteurs compatibles: | BIOC3, BIOPROX-EH, BIOPROX-MF, BIOPAD-M |
| Systèmes d'exploitation compatibles: | Windows 7, 8, 10 Windows Server 2008, 2012 |
| Capteur d'empreinte: | Optique (Surface du capteur sans rayures) |
| Resolution: | 500 dpi / 256 gris |
| Température de fonctionnement: | -10°C à +50°C |
| Dimensions (largeur x hauteur x prof.): | 66 x 58 x 90 mm |



► SPECIFICHE

| | |
|----------------------------|---|
| Interfaccia: | USB |
| Compatibilità software: | PROS CS e BIOMANAGER CS |
| Compatibilità del lettore: | BIOC3, BIOPROX-EH, BIOPROX-MF, BIOPAD-M |
| Compatibilità O/S: | Windows 7, 8, 10 Windows Server 2008, 2012 |
| Sensore impronte digitali: | Ottica (superficie del sensore priva di graffi) |
| Risoluzione: | 500 dpi/256 grigio |
| Temperature di esercizio: | da -10°C a +50°C |
| Dimensioni (lunxaltxlar): | 66 x 58 x 90 mm |

► ESPECIFICACIONES

| | |
|-------------------------------------|---|
| Interfaz: | USB |
| Software compatible: | PROS CS y BIOMANAGER CS |
| Lectores compatibles: | BIOC3, BIOPROX-EH, BIOPROX-MF, BIOPAD-M |
| Sistemas oper. compatibles: | Windows 7, 8, 10 Windows Server 2008, 2012 |
| Sensor de huella: | Óptico (superficie del sensor a prueba de rasguños) |
| Resolución: | 500 ppp / 256 grises |
| Temperatura de trabajo: | de -10°C a +50°C |
| Dimensiones (anch. x alt. x prof.): | 66 x 58 x 90 mm |

MERKMALE


| | |
|-------------------------|---|
| Schnittstelle: | USB |
| Softwarekompatibilität: | PROS CS und BIOMANAGER CS |
| Leser Kompatibilität: | BIOC3, BIOPROX-EH, BIOPROX-MF, BIOPAD-M |
| O/S Kompatibilität: | Windows 7, 8, 10, Windows Server 2008, 2012 |
| Fingerabdrucksensor: | Optisch (Sensoroberfläche ohne Kratzer) |
| Auflösung: | 500 dpi / 256 Graustufen |
| Betriebstemperatur: | -10°C bis +50°C |
| Abmessungen (HxBxT): | 66 x 58 x 90 mm |

SPECIFICATIES

| | |
|-----------------------------|--|
| Interface: | USB |
| Compatibele software: | PROS CS en BIOMANAGER CS |
| Compatibele lezers: | BIOC3, BIOPROX-EH, BIOPROX-MF, BIOPAD-M |
| Compat. besturingssystemen: | Windows 7, 8, 10 Windows Server 2008, 2012 |
| Vingerafdruksensor: | Optisch (krasvrij sensoroppervlak) |
| Resolutie: | 500 dpi / 256 gray |
| Bedrijfstemperaturen: | -10 °C tot +50 °C |
| Afmetingen (l x h x b): | 66 x 58 x 90 mm |

OPERATION


Plug the Desktop Reader (BIOE) in the PC. If the device is not installed automatically, use the drivers located on the web site. It is installed in the same way as an USB Device. When the desktop reader has been installed, it will automatically appear in the Software. (1.0)

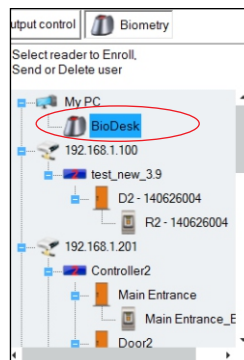

1.0

OPÉRATION


Brancher le lecteur de bureau (BIOE) au PC. Si le dispositif ne se connecte pas automatiquement, utiliser le pilote (driver) qui se trouve sur la page web (www.xprgroup.com) Il s'installe de la même manière qu'un dispositif USB. Quand le lecteur de bureau est installé, il apparaîtra automatiquement dans le logiciel. (1.0)

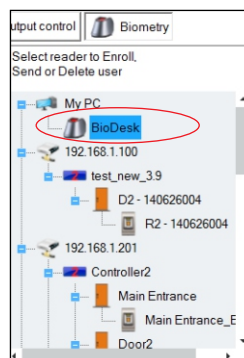

1.0

FUNZIONAMENTO


Collegare il lettore da scrivania (BIOE) al PC. Se il dispositivo non viene installato automaticamente, usare le unità disponibili sul sito Web. La procedura di installazione è uguale a quella che si usa per un dispositivo USB. Una volta installato, il lettore da scrivania apparirà automaticamente nel software. (1.0)

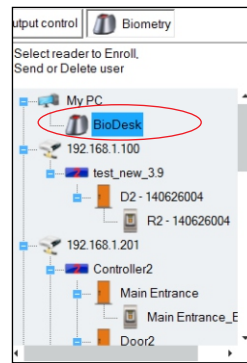

1.0

FUNCIONAMIENTO


Conecte el lector de mesa (BIOE) al PC. Si el dispositivo no se instala de forma automática, use los drivers que encontrará en el sitio web. Se instala de la misma manera que un dispositivo USB. Una vez que el lector de mesa se haya instalado, aparecerá automáticamente dentro del software. (1.0)

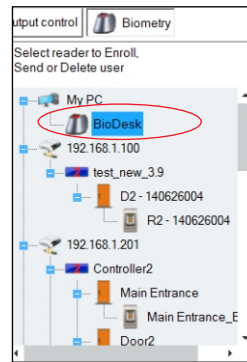

1.0

BEDIENUNG


Schließen Sie den Schreibtischleser (BIOE) an Ihren Computer an. Wenn das Gerät nicht automatisch installiert wird, verwenden Sie bitte den Treiber auf unserer Webseite (www.xprgroup.com). Er installiert sich wie ein USB Gerät. Wenn der Schreibtischleser installiert ist, erscheint er automatisch in der Software. (1.0)

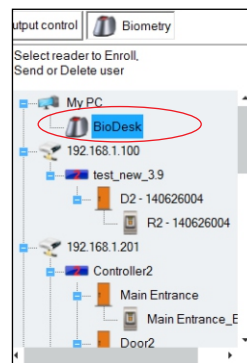

1.0

WERKING

Sluit de desktooplezer (BIOE) aan op de pc. Als het apparaat niet automatisch wordt geïnstalleerd, gebruikt u de stuurprogramma's op de website. Het wordt op dezelfde manier geïnstalleerd als een USB-apparaat. Wanneer de desktooplezer is geïnstalleerd wordt deze automatisch in de software weergegeven. (1.0)

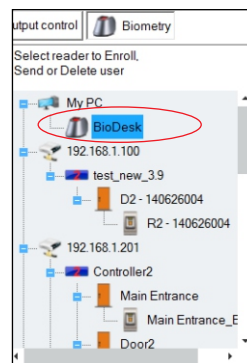

1.0

This product herewith complies with requirements of EMC directive 2014/30/EU. In addition it complies with RoHS2 directive EN50581:2012 and RoHS3 Directive 2015/863/EU. Ce produit est conforme aux exigences de la directive CEM 2014/30/UE. En outre, il est conforme à la directive RoHS2 EN50581:2012 et RoHS3 2015/863/EU. Questo prodotto è conforme ai requisiti della Direttiva EMC 2014/30/UE. Inoltre, è conforme alla Direttiva RoHS2 EN50581:2012 e RoHS3 2015/863/EU. Este producto cumple con los requisitos de la Directiva EMC 2014/30/UE. Cumple además con la Directiva RoHS2 EN50581:2012 y RoHS3 2015/863/EU. Dieses Produkt erfüllt die Bestimmungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU. Darüber hinaus entspricht es der RoHS2-Richtlinie EN50581:2012 und RoHS3-Richtlinie 2015/863/EU. Dit product voldoet aan de eisen van de EMC-richtlijn 2014/30/EU. En voldoet tevens aan de RoHS2-richtlijn (BGS) EN50581:2012 en RoHS3-richtlijn 2015/863/EU.

